



เพิ่มเข้าห้องรายนายกฯ  
 วันที่ 289 / พ.ศ. 69  
 วันที่ 6 มี.ค. 69 เวลา 15.46

ปลัด อบจ. ชัยภูมิ  
 เลขรับที่ 787 / 69  
 วันที่ 6 มี.ค. 2569  
 เวลา 14.38 น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข ฝ่ายบริการสาธารณสุข โทร. ๐๘๕ - ๕๙๓๑๔๕๕

ที่ ขย. ๕๑๐๐๖.๒/-

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๑ แห่ง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เพิ่มเข้าห้องนายก  
 วันที่ 690302252  
 วันที่ 17 มี.ค. 69 เวลา 14.50

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๓๓๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๑ แห่ง และให้ไปทำตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- |                               |                             |                         |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ๑. นายสมศักดิ์ หมูโพธิ์       | ผอ.รพ.สต. บ้านหลุมโพธิ์     | เป็นประธานกรรมการ       |
| ๒. นางสาวชिरญา ก้อนทอง        | ผอ.รพ.สต. หนองอีหล่อ        | เป็นกรรมการ             |
| ๓. นางสาวปริยรัศม์ เต๋อยโยชน์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

### ๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ บัดนี้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้วจึงขออนุมัติจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

#### ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๑ แห่ง

#### ๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับผิดชอบดูแลประชากรในพื้นที่ ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุม ทั้งด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค แต่เนื่องจากปัจจุบันยังขาดแคลนครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๑ แห่ง ๆ ละ ๑ ชุด ๆ ละ ๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ตามบันทึก

ตามบันทึก กองสาธารณสุข ที่ ขย ๕๑๐๐๖.๒/- ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง ขออนุมัติ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ จำนวน ๑๑ แห่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ จึงขอกำหนดร่างขอบเขตของงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

## ๒. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่
- ๒) เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีเครื่องนึ่ง ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ใช้ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

## ๓. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอ

- ๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕) ไม่เป็นบุคคลถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๘) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอราคาให้แก่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
- ๙) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑๐) ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ
- ๑๑) ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๑๒) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๑๓) ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีการเข้าสัญญาอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๑ แห่ง ๆ ละ ๑ ชุด ๆ ละ ๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

#### ๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร เป็นเครื่องฆ่าเชื้อแบบ Class N

๑.๒ การแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลอัตโนมัติแบบตัวหนาชัดเจน

๑.๓ เครื่องทำจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพสูง

๑.๔ การควบคุมอัตโนมัติโดยไมโครคอมพิวเตอร์ ตั้งค่าพารามิเตอร์การฆ่าเชื้อตามต้องการ

๑.๕ หน้าจอแสดงผลดิจิทัลและปุ่มสัมผัส

๑.๖ มีวัสดุปิดผนึก ที่สามารถขยายตัวอัตโนมัติ เพื่อปิดและกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของไอน้ำหรือลมออกจากภาชนะเพื่อความปลอดภัยขณะทำการฆ่าเชื้อ

๑.๗ ภาชนะที่มีฟังก์ชันป้องกันอัตโนมัติอย่างน้อยดังนี้ การป้องกันอุณหภูมิเกิน การป้องกันแรงดันเกินและระบายแรงดันอัตโนมัติ การป้องกันระดับน้ำต่ำและการป้องกันการไหม้แห้ง เป็นต้น

๑.๘ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติผ่านการรับรองมาตรฐานสากลอย่างน้อยดังนี้ CE, ISO๑๓๕๘๕ เป็นต้น พร้อมเอกสารรับรองแนบเพื่อประกอบการเสนอราคา

#### ๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

๒.๑ คุณสมบัติของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ มีดังนี้

๑) อุปกรณ์ล็อกความปลอดภัย (Safety Interlocking Device)

๒) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติมาพร้อมถังหรือตะกร้าสแตนเลส

๓) มีระบบหรือช่องเชื่อมต่อที่ถูกออกแบบและผ่านการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐาน

๔) มีระบบสัญญาณเตือนหลังการฆ่าเชื้อและหยุดการทำงานอัตโนมัติ

๕) มีระบบการระบายความร้อนอัตโนมัติและปล่อยไอน้ำออกอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดการ

ฆ่าเชื้อ

๖) ค่าพลังงานไฟฟ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ กิโลวัตต์

๗) ค่าแรงดัน (Design Pressure) มีค่าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ เมกะพาสกาล (Mpa)

๘) ความดันที่เครื่องสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง (Rated Working Pressure) อยู่ที่ระดับสูงสุดไม่น้อยกว่า ๐.๒๒ เมกะพาสกาล (Mpa) โดยไม่เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยงต่อระบบ เมื่อถึงระดับความดันที่กำหนด เครื่องจะรักษาความดันนี้ไว้ระหว่างกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อให้มั่นใจว่าจุลินทรีย์ทั้งหมดจะถูกทำลาย

๙) อุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๙ องศาเซลเซียส

๑๐) อุณหภูมิสำหรับการฆ่าเชื้อ (Sterilization Temperature) อยู่ในช่วงไม่น้อยกว่า

๑๑๖ - ๑๓๔ องศาเซลเซียส

๑๑) ค่าความ...

๑๑) ค่าความแม่นยำ (Accuracy) ของอุณหภูมิสำหรับการฆ่าเชื้อไม่เกินกว่า  $\pm 1$  องศาเซลเซียส

๑๒) สามารถตั้งค่าเวลาสำหรับการฆ่าเชื้อ (Sterilization Time Setting Range) อยู่ในช่วงไม่น้อยกว่า ๔ - ๑๒๐ นาที

๑๓) ขนาดความจุ (Chamber Volume) มีเส้นผ่านศูนย์กลางของห้องฆ่าเชื้อไม่น้อยกว่า ๓๕๐ มิลลิเมตร และมีความลึกของห้องฆ่าเชื้อไม่น้อยกว่า ๕๒๕ มิลลิเมตร

๑๔) ขนาดถังฆ่าเชื้อ (Bucket Dimension) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๓๐ มิลลิเมตร

๔. ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่ามีเอกสารรับรองเจ้าหน้าที่ว่ามีการผ่านการอบรมจากผู้ผลิต โดยตรงสำหรับการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถดูแลบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่า มีเอกสารแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิตเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าดังกล่าวได้ พร้อมเอกสารประกอบสำหรับการยื่นเสนอราคา

๖. ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่าผู้ผลิตชดเชยกันและแสดงความไม่เสถียรของแหล่งจ่ายไฟได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างน้อย ISO ๔๕๐๐๑:๒๐๑๘ เพื่อความปลอดภัยของการใช้งานเครื่องมือทางการแพทย์ พร้อมเอกสารแนบเพื่อประกอบการเสนอราคา

๗. ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่าโรงงานผู้ผลิตได้มาตรฐาน โดยมีเอกสารการทดสอบและรับรองมาตรฐานอย่างน้อย ดังนี้ CE, ISO๑๓๔๘๕ พร้อมเอกสารประกอบสำหรับการยื่นเสนอราคา

๘. ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่าเครื่องที่จำหน่ายและส่งมอบให้กับหน่วยงานเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน

๙. ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่าจะดำเนินการส่งมอบสินค้าภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

#### ๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๑. กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๒. กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน

#### ๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

#### ๘. ราคาากลาง แหล่งที่มาของราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ราคาที่ได้จากบัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภทครุภัณฑ์ การแพทย์ กลุ่มเครื่องมือจ่ายกลาง ชื่อรายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ราคา (ต่อหน่วย) ๘๐,๐๐๐ บาท/เครื่อง

- ราคาที่สืบราคาจากท้องตลาด จากบริษัทที่จำหน่าย เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร จำนวน ๓ บริษัท ได้แก่

๑) บริษัท เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

๒) บริษัท เมดิเทคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

๓) บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

- สรุปราคา จำนวน ๑๑ แห่ง ๆ ละ ๑ ชุด ๆ ละ ๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

#### ๙. สถานที่ส่งมอบ

- ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบพัสดุ ณ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การฯ สาย ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

#### ๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน


ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด


๑๑. อัตราค่าปรับ


- โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ

- ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องของพัสดุเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบการแจ้งความชำรุดเสียหาย หากไม่ดำเนินการแก้ไขในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการเองหรือจ้างบุคคลอื่นดำเนินการ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

(ลงชื่อ).....  ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหลุมโพธิ์ ประธานคณะกรรมการ  
(นายสมศักดิ์ หมูโพธิ์)

(ลงชื่อ).....  ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองอีหล่อ กรรมการ  
(นางสาวอชิรญา ก้อนทอง)

(ลงชื่อ).....  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวปรียรัศม์ เตื่อยโยชน์)


เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- เพื่อโปรดทราบ

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯ

เพื่อใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....   
(นายสังเวียน งาหัตถ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายวัลลภ ไชยคาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ความเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชรี แทนทรัพย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- อนุมัติตามเสนอ
- อื่นๆ.....

(ลงชื่อ).....


(นางสาวสุรีวรรณ นาคาศัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

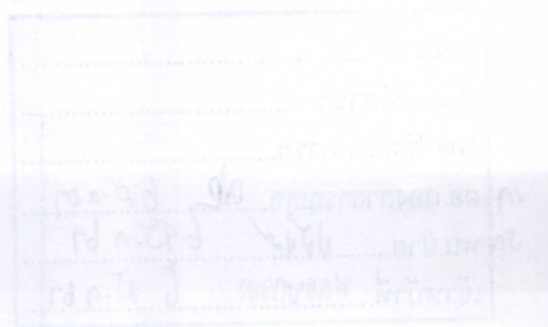


รายละเอียดแนบท้ายขอบเขตของงาน  
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ  
ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๑ แห่งๆ ละ ๑ ชุด


ที่	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	จำนวน (ชุด)	งบประมาณ (บาท)
๑	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพีพวน	๑ ชุด	๘๐,๐๐๐.-
๒	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดยาง	๑ ชุด	๘๐,๐๐๐.-
๓	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจาบ	๑ ชุด	๘๐,๐๐๐.-
๔	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอีหล่อ	๑ ชุด	๘๐,๐๐๐.-
๕	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแคน	๑ ชุด	๘๐,๐๐๐.-
๖	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา	๑ ชุด	๘๐,๐๐๐.-
๗	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน	๑ ชุด	๘๐,๐๐๐.-
๘	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำมุลนาก	๑ ชุด	๘๐,๐๐๐.-
๙	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์	๑ ชุด	๘๐,๐๐๐.-
๑๐	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำมมงคล	๑ ชุด	๘๐,๐๐๐.-
๑๑	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะลอมไผ่	๑ ชุด	๘๐,๐๐๐.-

(ลงชื่อ).....  


(นายสมศักดิ์ หมูโพธิ์)  
ผ.รพ.สต.บ้านหลุบโพธิ์

(ลงชื่อ).....  


(นางสาวอชิรญา ก้อนทอง)  
ผ.รพ.สต.หนองอีหล่อ

(ลงชื่อ).....  


(นางสาวปรีรัตน์ เตื่อยโยชน์)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ